


فرآیند اسقاط تجهیزات پزشکی اموال

تاریخ تنظیم: ۹۸/۹/۱۲
شماره بازنگری: B

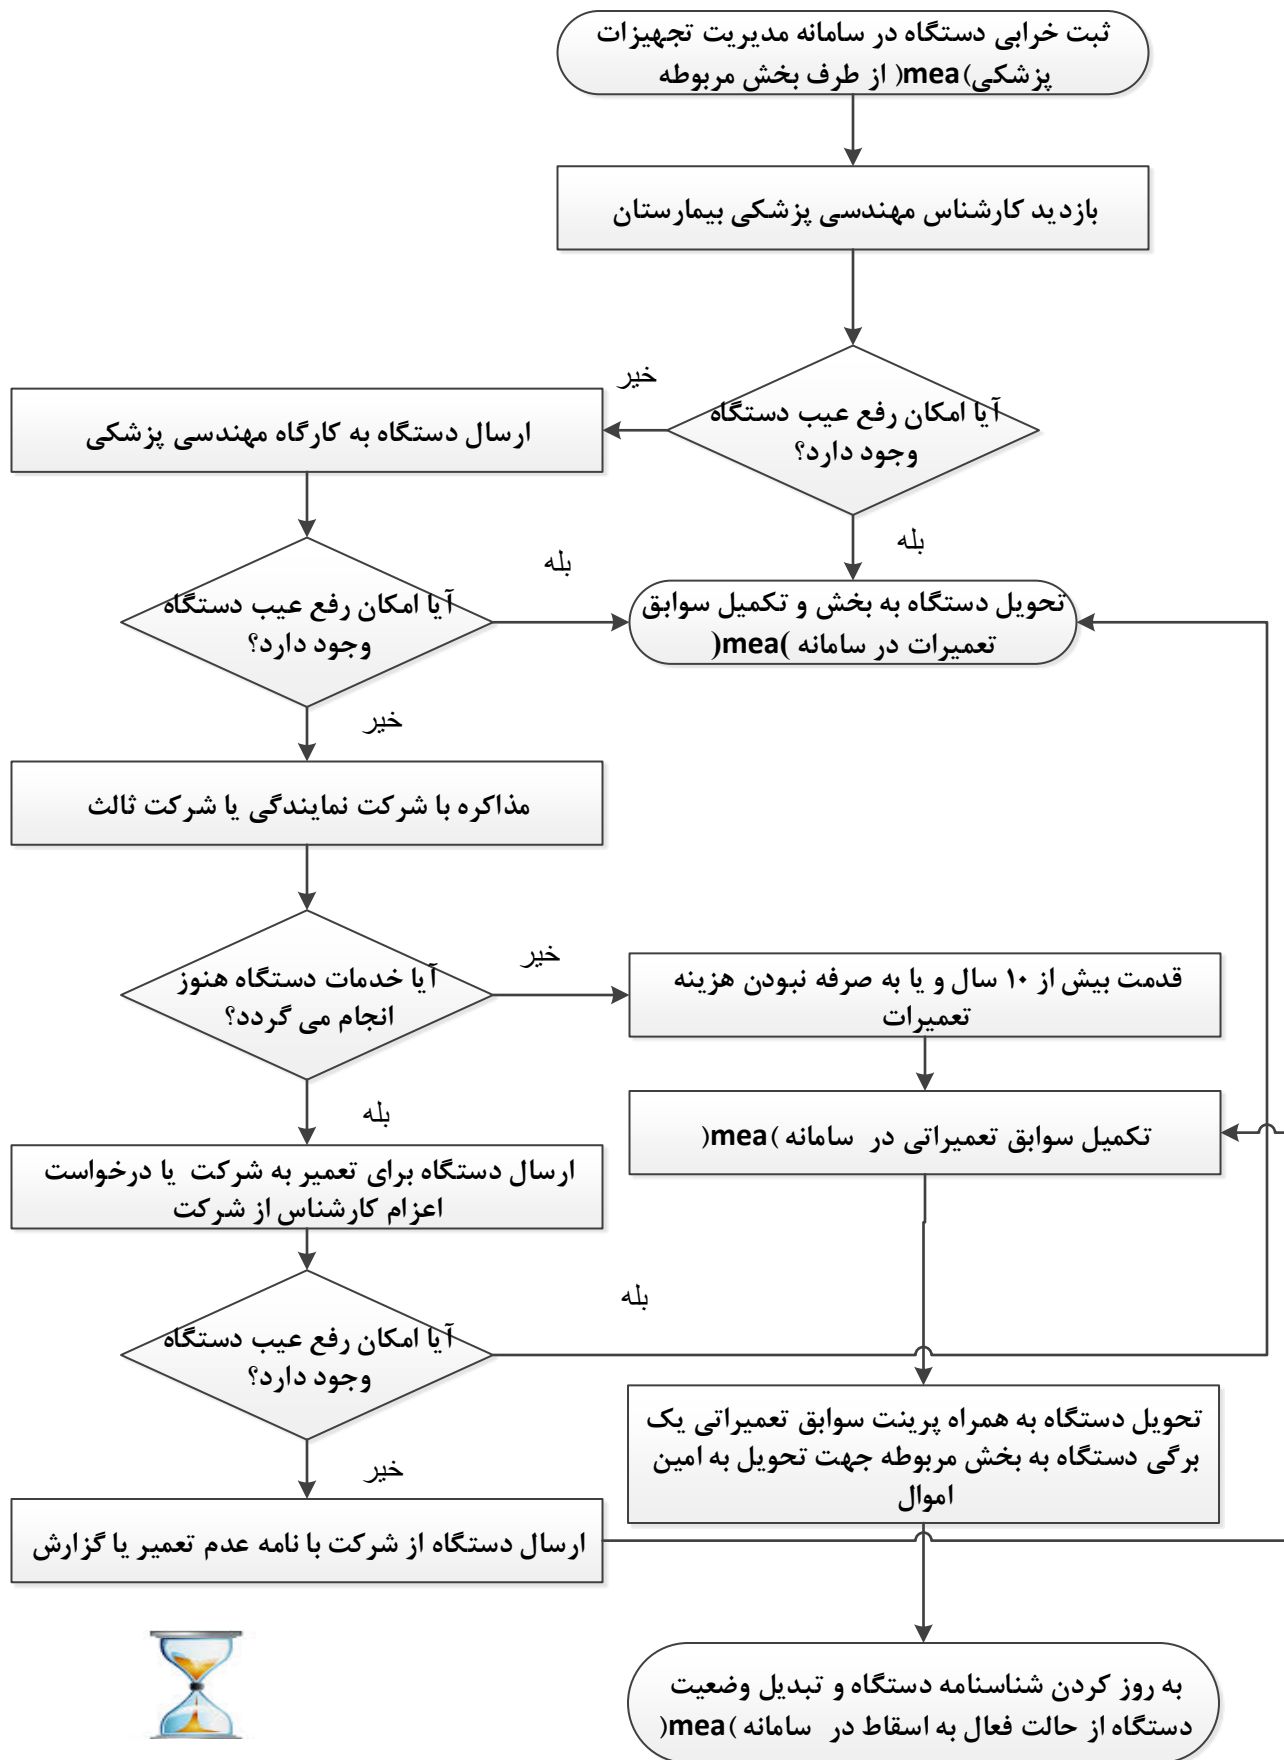

مدت زمان: از ۱ روز تا ۹۰ روز